
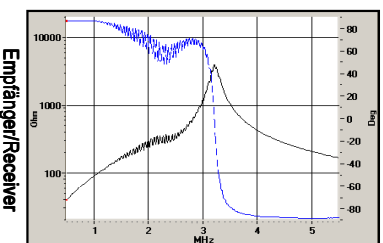
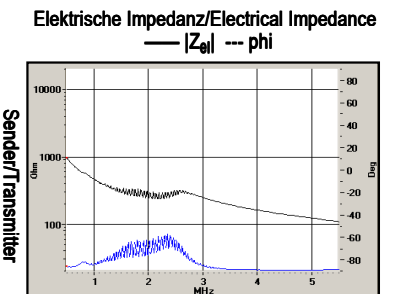
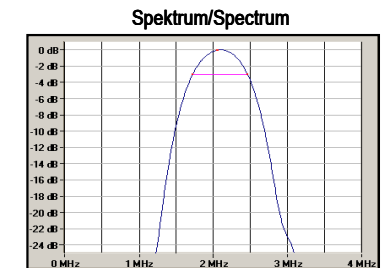
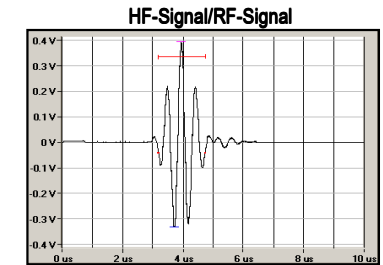
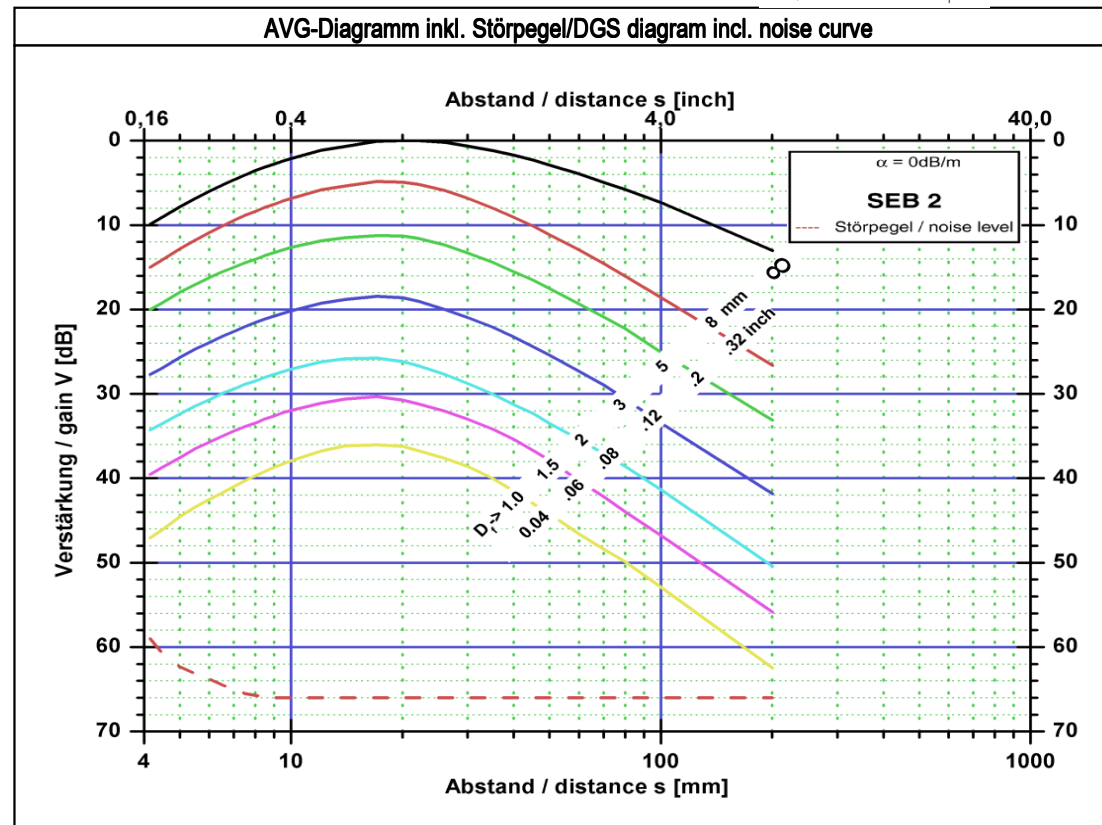


| Technische Daten/technical data                           |                |                    |             |
|---|----------------|--------------------|-------------|
| Symbol  | Soll Reference | Toleranz Tolerance | Dimension   |
| T <sub>10</sub>   | 1,5            | ± 0,5              | µs          |
| f <sub>0</sub>  | 2              | ± 0,2              | MHz         |
| Δf <sub>rel</sub>   | 48             | ± 7                | %           |
| S <sub>rel</sub>  | -53            | ± 3                | dB          |
| C <sub>a</sub>  | >44            |                    | dB          |
| δ   | 0              | ± 2                | Grad/degree |
| Z   | 0              | ± 1                | mm          |
| F   | 15             | ± 3                | mm          |
| FB <sub>6</sub>   | 3,5            | ± 0,7              | mm          |
| FL <sub>6</sub>   | 6,5            | ± 1,3              | mm          |
| L <sub>6</sub>  | 40             | ± 8                | mm          |
| D <sub>O</sub>  | 7 x 18         | -0,1               | mm x mm     |
| M <sub>Z</sub>  | 6              |                    | mm          |
| T <sub>a</sub>  | -20... +60     |                    | °C          |
| Ebenheit der Kontaktfläche<br>Flatness of contact surface |                |                    | <0,05 mm    |
| <b>US-Gerät/US Instrument</b>                             |                |                    |             |
| USM 25  |                |                    |             |
| <b>Sendereinstellung/Pulser setting</b>                   |                |                    |             |
| Intensität/Intensity                                      | gross/high     |                    |             |
| PK-Anpassung/Damping                                      | gross/high     |                    |             |
| IFF-Art/PRF Mode  | 6              |                    |             |
| Schwingermaterial/transducer material                     | Piezokeramik   |                    |             |
| Gewicht/weight:   | 190 g          |                    |             |
| Anschluss/connector:                                      | LEMO 00        |                    |             |

**DATENBLATT/DATA SHEET**  
nach/according to EN 12668-2

**SEB 2 EN**                      **No. 500063 + SEKG 2**

Gültig für Prüfköpfe ab: SN 00501  
Valid for probes from: SN 00501  
Id.-No. 28751 001/07.2005



## Notice

This data sheet gives comprehensive information on all probes with the given codes. The data shows you that, with their tight tolerances, these probes well deserve the designation „true-to-specification“.

1. The TR probes in most cases have an integrated matching coil. Therefore a special probe cable is required when connecting to an ULTRASONIC FLAW DETECTOR. If the red lead is connected to the receiver socket of the instrument (with more recent ULTRASONIC FLAW DETECTORS this is marked red) then optimal testing properties can be achieved. Incorrect polarity can result in a worsening of the sensitivity and the resolution.
2. Our probes are being continually improved in keeping with the latest state of technology. Please let us know if you have special requirements - perhaps we can include them in our next changes!

All values refer to steel as described in EN 12223 concerning manufacture of calibration block no. 1, in the temperature range  $23 \pm 5^\circ\text{C}$ .

## Hinweis

Dieses Datenblatt gibt Ihnen umfassende Informationen über alle Prüfköpfe mit dem aufgeführten Kurzzeichen. Die Daten zeigen Ihnen mit ihren engen Toleranzen, dass diese Prüfköpfe die Bezeichnung „datentreu“ verdienen.

1. Die SE-Prüfköpfe haben eine eingebaute Anpassspule. Deshalb ist für den Anschluss an ein Ultraschallprüfgerät ein spezielles Prüfkabel erforderlich. Wird die rote Kabelader mit der Empfängerbuchse des Geräts verbunden (bei neueren IMPULS-SCHALL-GERÄTEN rot gekennzeichnet), so sind optimale Prüfeigenschaften zu erzielen. Bei falscher Polung können sich Empfindlichkeit und Auflösung verschlechtern.
2. Unsere Prüfköpfe werden ständig entsprechend neuesten Erkenntnissen verbessert. Bitte informieren Sie uns, wenn sie spezielle Verbesserungswünsche haben. Wir können sie vielleicht schon bei der nächsten Änderung berücksichtigen.

Alle Werte beziehen sich auf Stahl, wie in EN 12223 zur Herstellung des Kalibrierkörpers Nr. 1 beschrieben, im Temperaturbereich  $23 \pm 5^\circ\text{C}$ .

## Legende/legend

| Symbol           | Beschreibung                                | Description                           |
|------------------|---|---------------------------------------|
| $T_{10}$         | Echoimpulsdauer                             | Echo pulse duration                   |
| $f_0$            | Mittenfrequenz                              | Centre frequency                      |
| $\Delta f_{rel}$ | Relative Bandbreite @ -6dB                  | Relative bandwidth @ -6dB             |
| $S_{rel}$        | Relative Echo-Empfindlichkeit               | Relative pulse-echo sensitivity       |
| $C_a$            | Übersprechdämpfung                          | Cross talk                            |
| $\delta$         | Schielwinkel                                | Squint angle                          |
| Z                | Versatz                                     | Offset                                |
| F                | Fokusabstand                                | Focal distance                        |
| $FB_6$           | Fokusbreite senkr. zur Trennschicht @ -6dB  | Focal width perpend. to barrier @-6dB |
| $FL_6$           | Fokusbreite parall. zur Trennschicht @ -6dB | Focal width parall. to barrier @-6dB  |
| $L_6$            | Länge Fokus @ -6dB                          | Focal Length @-6dB                    |
| $D_o$            | Wandlergröße                                | Transducer dimensions                 |
| $M_z$            | Erlaubte Abnutzung                          | Wear allowance                        |
| $T_a$            | Arbeitstemperaturbereich                    | Working temperature range             |
| $ Z_{el} $       | Betrag der elektrischen Impedanz            | Electrical impedance modulus          |
| phi              | Phase der elektrischen Impedanz             | Phase of electrical impedance         |
| $D_f$            | Ersatzreflektorgröße                        | Reference reflector size              |